


Neotech RAM Cannula[®]

CÂNULA NASAL PARA OXIGÊNIO

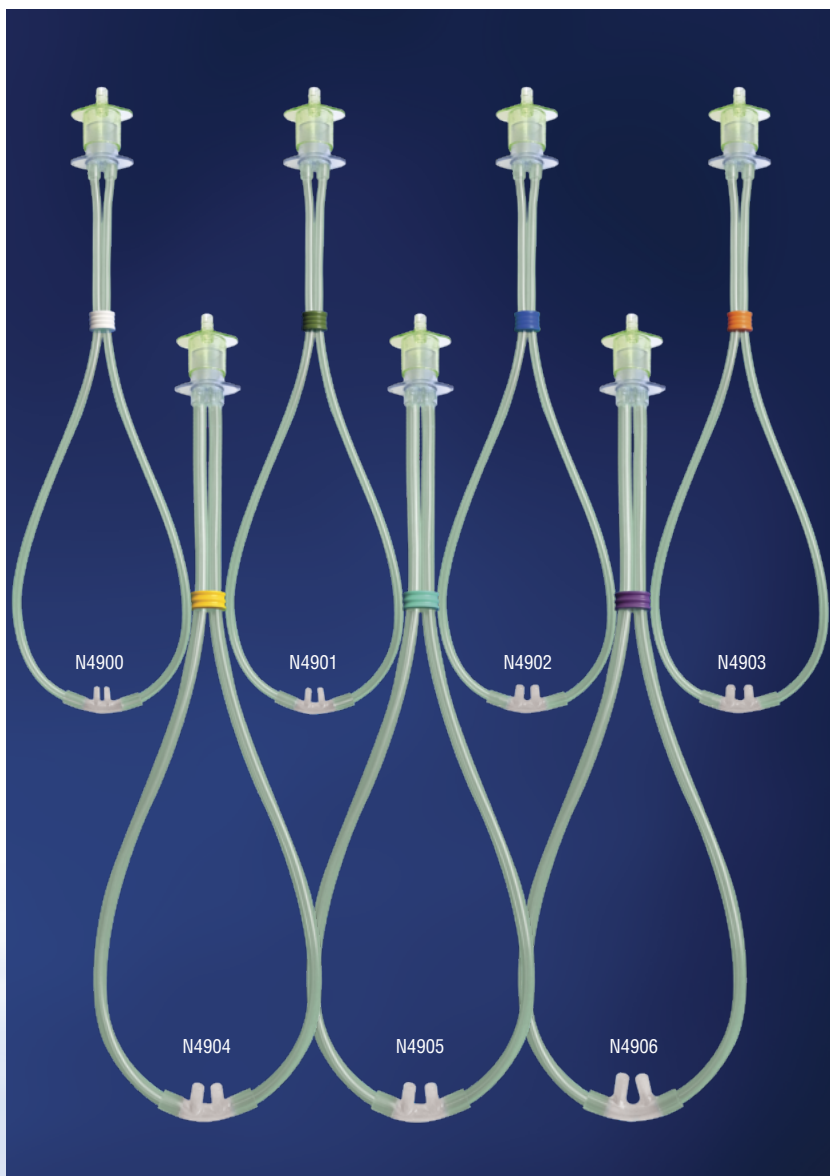

— CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS —

- Para uso com oxigênio humidificado de baixo / alto fluxo
- Pontas suaves e curvas
- Tamanhos codificados por cores
- Adaptador de tubo de oxigênio de 15 mm incluído
- Não fabricado com látex de borracha natural ou plastificante DEHP
- Embalado individualmente

Número	Item	Qty/Unidade
N4900	Branca	10/caixa
N4901	Verde	10/caixa
N4902	Azul	10/caixa
N4903	Laranja	10/caixa
N4904	Amarela	10/caixa
N4905	Cerceta	10/caixa
N4906	Roxa	10/caixa
N4820	Adaptador de tubo de oxigênio	50/caixa



Feito nos Estados Unidos



Clínico Inventado



Corporation

Patente dos EUA #8,353,296; #D681,193; #9,027,562; #9,808,593; #9,861,777; Patentes estrangeiras adicionais pendentes

Neotech RAM Cannula®

CÂNULA NASAL PARA OXIGÊNIO

INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

A Neotech RAM Cannula destina-se a ser utilizada em recém-nascidos prematuros e a termo, bebês e doentes pediátricos que necessitem de oxigênio suplementar, suporte respiratório ou assistência respiratória num ambiente ambulatorio, hospitalar ou institucional. É usada para fornecer oxigênio com os seguintes métodos:

1. Oxigênio de baixo fluxo humidificado, aquecido ou não aquecido.
2. Oxigênio de alto fluxo humidificado e aquecido

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- 1 Selecione a cânula de tamanho adequado usando o guia de tamanhos de RAM fornecido na embalagem. As cânulas de tamanho ideal preencherão aproximadamente 80% das narinas. Certifique-se de que a cânula não ocupa completamente as narinas.
- 2 Conecte o adaptador do tubo de oxigênio de 15 mm (fornecido) à cânula RAM. Fixe a cânula na fonte de oxigênio. Certifique-se de que todas as ligações da cânula estão adequadamente protegidas.
- 3 Abra e teste o nível de fluxo de oxigênio antes de colocar o dispositivo no paciente.
- 4 Insira a cânula nas narinas do paciente, deixando um pequeno espaço entre o septo do paciente e a base da cânula.
- 5 Prenda a cânula de frente para a abraçadeira e da cânula EZ-Hold® ou produto semelhante.
- 6 Substitua a Neotech RAM Cannula a cada 14 dias ou de acordo com o protocolo hospitalar, o que ocorrer primeiro. Deite a cânula de RAM usada fora de acordo com o protocolo hospitalar.

— CONTRA-INDICAÇÕES, PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS —

A Neotech RAM Cannula é contraindicada para pacientes com atresia nasal ou pacientes com deformidades na estrutura facial que impeçam um suporte respiratório adequado.

Segundo a legislação em vigor, a venda deste dispositivo está sujeita a receita ou indicação médica.

Este dispositivo só deve ser usado enquanto o paciente estiver sob supervisão contínua e direta do profissional de saúde e for necessária observação frequente da posição da cânula nas narinas do paciente. Seleção inadequada do tamanho, posicionamento ou uso inadequado podem resultar em trauma ou necrose septal.

O tubo da cânula pode representar um possível risco de estrangulamento. Não use o O-ring para prender o dispositivo ao paciente.

Comece sempre pelo fluxo de gás antes de inserir as cânulas nas narinas do paciente.

Não use se a embalagem estiver danificada ou aberta.

Não molhe, lave ou esterilize.

A reutilização deste dispositivo pode resultar em contaminação cruzada.

Descontinuar imediatamente a utilização em caso de irritação cutânea.

Utilizar apenas num único paciente.

Resistência ao Fluxo

N4900, N4901, N4902, N4903

0.446 cmH₂O / L / min @ 2.5 LPM

N4904, N4905, N4906

0.230 cmH₂O / L / min @ 15 LPM



2797

EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60
6827 AT, Arnhem
The Netherlands

Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, 91355, USA

©2025 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech. M688 Rev E 2025.10.20